Ministerio de Salud
Personas que atendemos Personas

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección Regional de Salud

FORMATO 16 : Reporte - Monoxido de Carbono (CO)

Ciudad: : Trujillo
Nombre/Numero de la Estación : Caseta 1
Ubicación : Hospital Regional Docente de Trujillo
Método de Muestreo y Análisis : Infrarrojo IRND (Método Automático)
Equipo de Muestreo : Analizador de CO - Monitor APY Teledyne
Codigo del Equipo: :
Ultima Calibración del Equipo :
ECA :30000 µg/m³ para 1 Horas

Mes : Agosto
Año : 2007
Semana Epidemiologica :
Operador : Blgo Wendy Zelada.
Responsable: :DIRES LL -DESA
Tipo de Data : Horario
Unidades: : µg/m^3
Limite de Deteccion : --- µg/m3

DIA / HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Prom	Valor Max.
00:00															933													0	0	0	0	187	933
01:00			933																									0	0	0	0	187	933
02:00				594																								0	0	0	0	119	594
03:00																												0	0	0	0	0	0
04:00																												0	0	0	0	0	0
05:00				945																								0	0	0	0	189	945
06:00	729	616																										0	0	0	0	224	729
07:00	1101	893	661		374	763	459	505	360	787			452	686		975									372			0	0	0	0	493	1101
08:00	1317	1058	715	1014		807	975	838	757	582	941		594	670	897		825	569		737		744	920	918			549	0	0	0	0	684	1317
09:00	1668	973	807	1069	522	829	1001	908	821	610	948		572		835	964	746	596		730	935	635	925					0	0	0	0	712	1668
10:00	1583	921	935	1036	588	924	1052	915	862	647	912		591	680		1034	808	569		649		529						0	0	0	0	692	1583
11:00		980	1012	875	588	1008	1063	947	781	650	833		625	680	1113	1065	888	549			727							0	0	0	0	685	1113
12:00	1638		909	696	577	1085	1059	888	781	700	744			691	1225	1032	884											0	0	0	0	717	1638
13:00	1543		946		522	1142	1030		807	675			639	631	1255	1104												0	0	0	0	686	1543
14:00						1209	1043		842							742	977							879				0	0	0	0	569	1209
15:00						979	870		666	682					1230		947											0	0	0	0	537	1230
16:00		908	904			862	746	879		536							819							805				0	0	0	0	538	908
17:00		908	707			843	683	930		463					1184	654	735				650							0	0	0	0	554	1184
18:00	1400	887	666		428	832	577	838	538	475			674		920	528	726				614			565				0	0	0	0	562	1400
19:00	1468	689	663	615	395	821	537	652	472	526	614		465	620	799	503	663	539			668		914	349				0	0	0	0	541	1468
20:00	1362	624	685	633		803	482	578	403	610	553		478		1143	532	642	541					1011	354				0	0	0	0	544	1362
21:00	1204		772	674		760	464	525	366	663	435		472		933	550	678	495										0	0	0	0	499	1204
22:00	842	602	882	622						725					1143													0	0	0	0	408	882
23:00	862																											0	0	0	0	334	1143
Prom.	1285.84	838.28871	813.1206	797.5291763	499.4691	911.12	802.74	783.63	650.43	622.015	747.5	#¡DIV/0!	556.3	665.311	1047	806.981	795.14	551.02	#¡DIV/0!	705.36	718.89	635.86	942.58	645.01	372.38	######	549.154506	0	0	0	0		
V. Max..	1668	1058	1012	1069	588	1209	1063	947	862	787	948	0	639	691	1255	1104	977	596	0	737	935	744	925	918	372	0	549	0	0	0	0		
V. Min.	729	616	661	696	374	763	459	505	360	463	744	0	452	631	835	654	735	549	0	649	650	529	920	805	372	0	549	0	0	0	0		

Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento ( ), Calibracion ( ) y Otros ( )

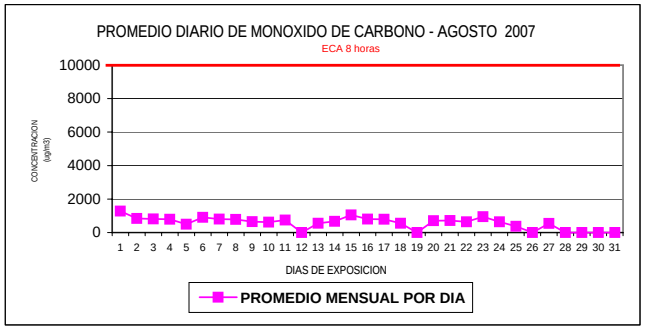

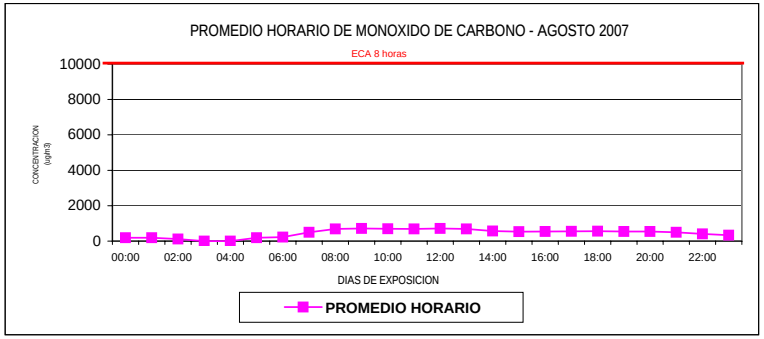

Valor Min.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0